

# 多探头紫外辐照计

型号：HT1925

使用说明书 V3.37

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

## 一、产品简介

多探头紫外辐照计，采用数字探头，插拔式设计，一台主机可以同时支持多种探头，仪器智能判断探头的型号。根据测试的紫外线光谱范围，量程，测光孔的大小，应用行业等的不同，目前开发了 12 种不同紫外线探头：

| 编号 | 探头型号        | 光谱响应        | 测光孔直径  | 应用行业                    |
|----|-------------|-------------|--------|-------------------------|
| 1  | UVC-X0探头    | 230nm-280nm | Φ 10mm | 254nm紫外杀菌汞灯强度和能量测量      |
| 2  | UVCWP-X1探头  | 230nm-280nm | Φ 10mm | 254nm紫外杀菌汞灯强度和能量测量，1米防水 |
| 3  | UVC-X2探头    | 210nm-250nm | Φ 10mm | 222nm紫外杀菌灯强度和能量测量       |
| 4  | UVCLED-X0探头 | 230nm-315nm | Φ 10mm | 260nm-285nm LED杀菌灯测试    |
| 5  | UVB-X0探头    | 280nm-315nm | Φ 10mm | 通用UVB强度和能量测量            |
| 6  | UVA-X0探头    | 315nm-400nm | Φ 10mm | 紫外固化，高压汞灯强度和能量测量        |
| 7  | UVA-X1探头    | 315nm-400nm | Φ 10mm | 低量程通用UVA强度和能量测量         |
| 8  | UVA-X2探头    | 315nm-365nm | Φ 10mm | 340nm老化灯强度和能量测量         |
| 9  | UVALED-X0探头 | 340nm-420nm | Φ 10mm | 紫外固化，UV LED面光源强度和能量测量   |
| 10 | UVALED-X1探头 | 340nm-420nm | Φ 1mm  | 紫外固化，UV LED点光源强度和能量测量   |
| 11 | UVALED-X3探头 | 340nm-420nm | Φ 10mm | 低量程通用UVA+UVV LED强度和能量测量 |
| 12 | BL-X0探头     | 410nm-490nm | Φ 10mm | 450nm蓝光强度和能量测量          |

### 产品符合标准：

JJG 879-2015紫外辐射照度计检定规程。

WST 367-2012 医疗机构消毒技术规范

QBT 2826-2006 胶印紫外光固化油墨

## 二、探头参数

### 1. UVC-X0 探头

- 1) 光谱响应: 230nm-280nm,  $\lambda_p = 254\text{nm}$
- 2) 功率测量范围: 0 - 200000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率: 0.1  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围: 0 - 9999999  $\mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间: 0 - 99999S
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 直径39mm×厚15mm

### 2. UVCWP-X1 探头

- 1) 光谱响应: 230nm-280nm,  $\lambda_p = 254\text{nm}$
- 2) 功率测量范围: 0 - 200000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率: 0.1  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围: 0 - 9999999  $\mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间: 0 - 99999S
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 直径50mm×厚20mm
- 11) 防水深度: 1 米

### 3. UVC-X2 探头

- 1) 光谱响应: 210nm-250nm,  $\lambda_p = 222\text{nm}$
- 2) 功率测量范围: 0 - 200000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率: 0.1  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围: 0 - 9999999  $\mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间: 0 - 99999S
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 直径39mm×厚15mm

### 4. UVCLED-X0 探头

- 1) 光谱响应: 230nm-315nm, 适用于260nm-285nm LED杀菌灯测试, (宽光谱探头, 避免在强外界光下使用)
- 2) 功率测量范围: 0 - 200000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率: 0.1  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围: 0 - 9999999  $\mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间: 0 - 99999S
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 直径39mm×厚15mm

### 5. UVB-X0 探头

- 1) 光谱响应: 280nm-315nm,  $\lambda_p = 310\text{nm}$ , 适用于297nm, 308nm, 313nm 等波长的UVB 光源测量
- 2) 功率测量范围: 0 - 200000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率: 0.1  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999\text{S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10 \text{ mm}$
- 10) 探头尺寸: 直径 $39\text{mm} \times$ 厚 $15\text{mm}$

## 6. UVA-X0 探头

- 1) 光谱响应:  $315\text{nm}-400\text{nm}$ ,  $\lambda_p = 365\text{nm}$
- 2) 功率测量范围:  $0 - 2000 \text{ mW}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $0.1 \text{ mW}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999\text{mJ}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999\text{S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 5\text{mW}/\text{cm}^2$ :  $\pm 0.5\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 5\text{mW}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 2048次/秒
- 8) 可选单位:  $\text{mW}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 长 $39\text{mm} \times$ 宽 $32\text{mm} \times$ 厚 $15\text{mm}$

## 7. UVA-X1 探头

- 1) 光谱响应:  $315\text{nm}-400\text{nm}$ ,  $\lambda_p = 365\text{nm}$
- 2) 功率测量范围:  $0 - 200000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $0.1 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999\text{S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$

- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 长 $39\text{mm}$ ×宽 $32\text{mm}$ ×厚 $15\text{mm}$

## 8. UVA-X2 探头

- 1) 光谱响应:  $315\text{nm}-365\text{nm}$ ,  $\lambda_p = 340\text{nm}$
- 2) 功率测量范围:  $0 - 200000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $0.1 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \mu\text{J}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999\text{S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 长 $39\text{mm}$ ×厚 $15\text{mm}$

## 9. UVALED-X0 探头

- 1) 光谱响应:  $340\text{nm}-420\text{nm}$ , 仪器校准于 $395\text{nm}$  LED光源
- 2) 功率测量范围:  $0 - 200000 \text{mW}/\text{cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $1 \text{mW}/\text{cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \text{mJ}/\text{cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999\text{S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \text{mW}/\text{cm}^2$ :  $\pm 5 \text{mW}/\text{cm}^2$ ,  $H \geq 50 \text{mW}/\text{cm}^2$ :  $\pm 10\%H$
- 7) 取样速度: 2048次/秒
- 8) 可选单位:  $\text{mW}/\text{cm}^2$  (默认),  $\text{W}/\text{cm}^2$ ,  $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸: 长 $39\text{mm}$ ×宽 $32\text{mm}$ ×厚 $15\text{mm}$

## 10. UVALED-X1 探头

- 1) 光谱响应:  $340\text{nm}-420\text{nm}$ , 仪器校准于 $395\text{nm}$  LED光源

- 2) 功率测量范围:  $0 - 200000 \text{ mW/cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $1 \text{ mW/cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \text{ mJ/cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999 \text{ S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \text{ mW/cm}^2$ :  $\pm 5 \text{ mW/cm}^2$ ,  $H \geq 50 \text{ mW/cm}^2$ :  $\pm 10\% H$
- 7) 取样速度: 2048次/秒
- 8) 可选单位:  $\text{mW/cm}^2$  (默认),  $\text{W/cm}^2$ ,  $\text{W/m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 1 \text{ mm}$
- 10) 探头尺寸: 长39mm×宽32mm×厚15mm

## 11. UVALED-X3 探头

- 1) 光谱响应: 340nm-420nm, 仪器校准于395nm LED光源
- 2) 功率测量范围:  $0 - 200000 \text{ } \mu \text{W/cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $0.1 \text{ } \mu \text{W/cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \text{ } \mu \text{J/cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999 \text{ S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 50 \text{ } \mu \text{W/cm}^2$ :  $\pm 5 \text{ } \mu \text{W/cm}^2$ ,  $H \geq 50 \text{ } \mu \text{W/cm}^2$ :  $\pm 10\% H$
- 7) 取样速度: 6次/秒
- 8) 可选单位:  $\text{ } \mu \text{W/cm}^2$  (默认),  $\text{mW/cm}^2$ ,  $\text{W/m}^2$
- 9) 测试光孔直径:  $\Phi 10 \text{ mm}$
- 10) 探头尺寸: 长39mm×宽32mm×厚15mm

## 12. BL-X0 探头


- 1) 光谱响应: 410nm-490nm,  $\lambda_p = 450 \text{ nm}$
- 2) 功率测量范围:  $0 - 2000 \text{ mW/cm}^2$
- 3) 功率分辨率:  $0.1 \text{ mW/cm}^2$
- 4) 能量测量范围:  $0 - 9999999 \text{ mJ/cm}^2$
- 5) 记录时间:  $0 - 99999 \text{ S}$
- 6) 测量精度(H为标准值):  $H < 5 \text{ mW/cm}^2$ :  $\pm 0.5 \text{ mW/cm}^2$ ,  $H \geq 5 \text{ mW/cm}^2$ :  $\pm 10\% H$

- 7) 取样速度：2048次/秒
- 8) 可选单位： $\text{mW}/\text{cm}^2$ （默认）， $\text{W}/\text{m}^2$
- 9) 测试光孔直径： $\Phi 10\text{mm}$
- 10) 探头尺寸：长 $39\text{mm}$ ×厚 $15\text{mm}$


### 三、主机参数

- 1. 仪器重量：约194克
- 2. 主机尺寸：长 $148\text{mm}$  × 宽 $76\text{mm}$  × 高 $26\text{mm}$
- 3. 显示屏：240\*160 点阵 LCD
- 4. 供电方式：4节AAA碱性干电池
- 5. 探头连接方式：推拉自锁（卡扣式）连接器
- 6. 供电电压：DC5V
- 7. 工作电流：20mA
- 8. 工作功耗：100mW

### 四、探头光谱响应曲线

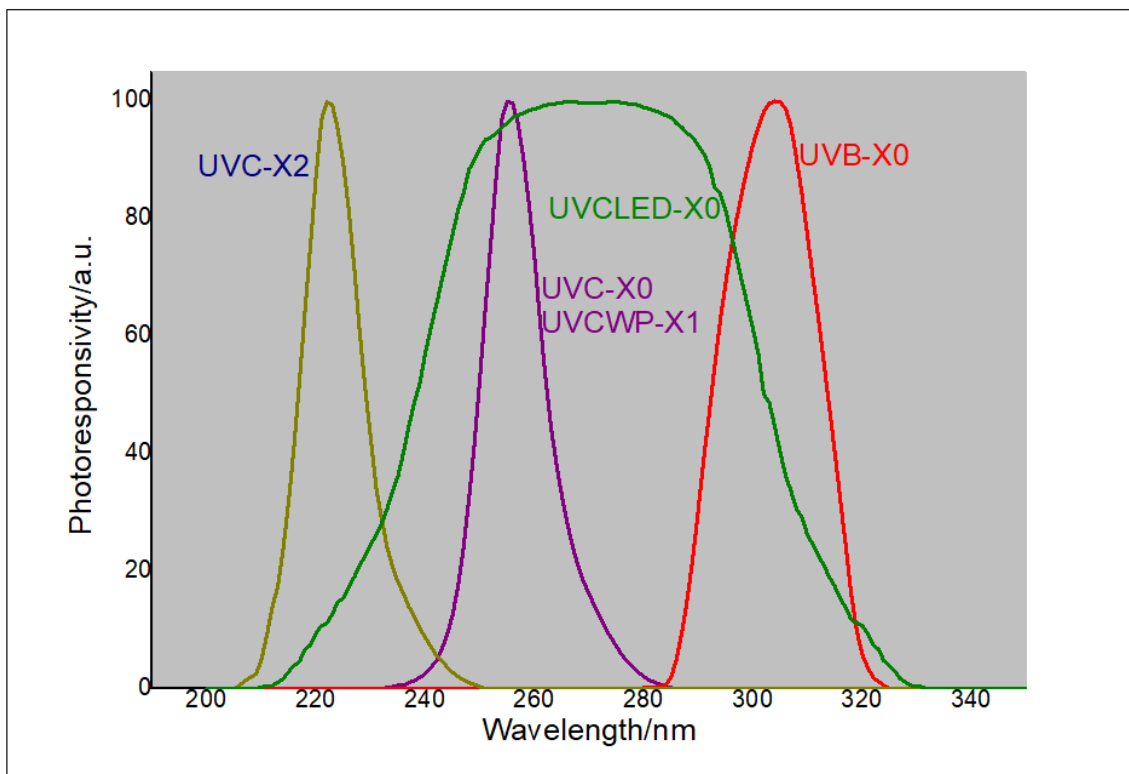



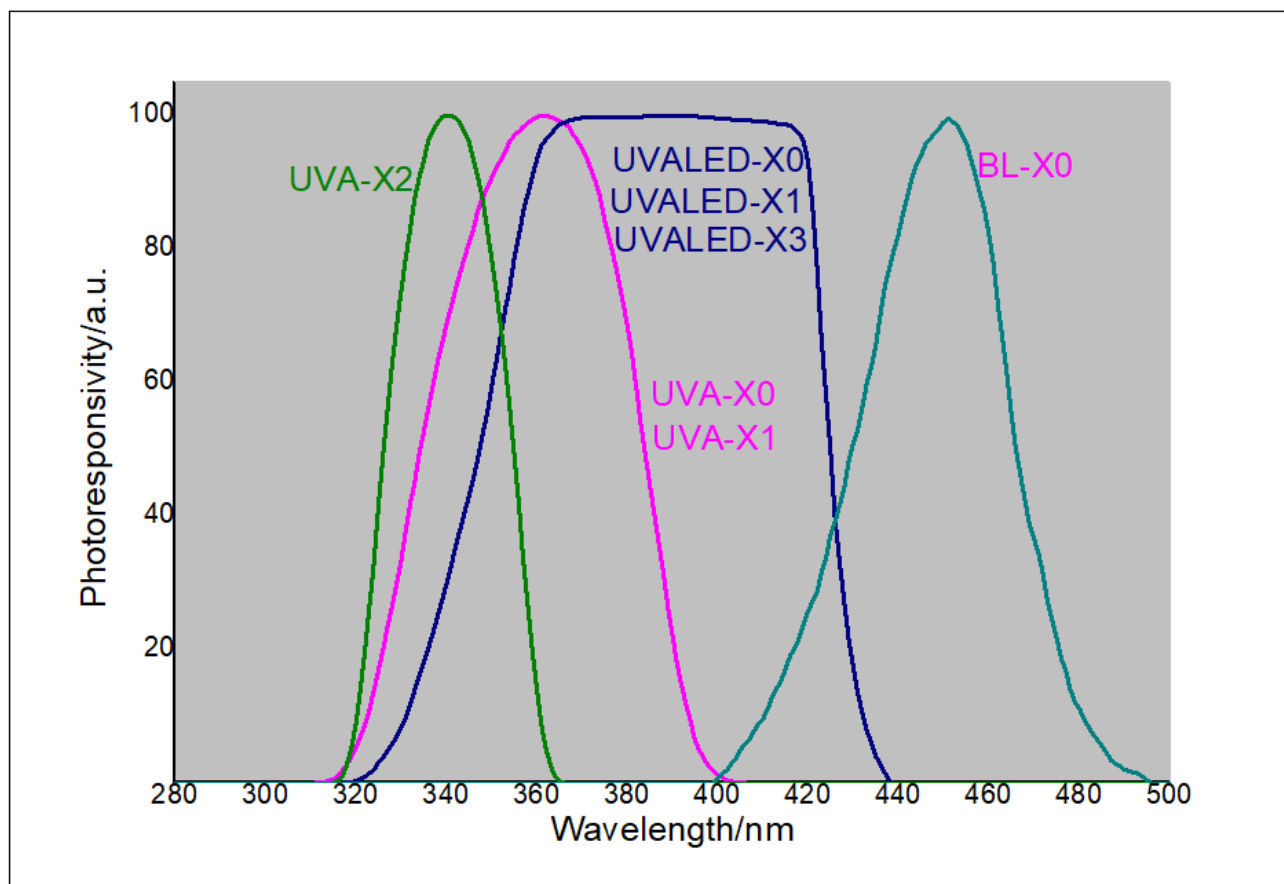


## 五、产品特点

1. 探头插拔式设计，一台主机可支持多种紫外探头。
2. 采用先进的数字探头技术，探头不易受到干扰并且提供优良的测量精度。
3. 仪器智能识别探头的型号，仪器根据探头类型自适应显示界面。
4. 各种不同的光谱范围，量程，测光孔大小的探头来适应不同应用行业。
5. 针对LED点光源，采用1mm光孔设计，方便光源与光孔对位。
6. 丰富统计功能，实时值、最大值、最小值、平均值，时间，能量值同时显示。

## 六、仪器操作

### 1. 开/关机

- **开机：**短按“”键执行开机操作，开机后分别显示主机参数、探头参数，进入到测量界面。如下图：

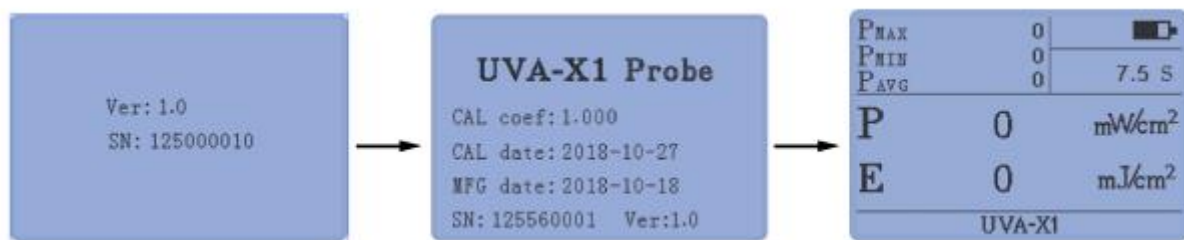


- **关机：**长按“”键关机；或 10 分钟无操作自动关机（Auto Off = ON）。
- 自动关机自动保存关机时刻的测量数据到历史记录中。（No. 1，即最后一组被记录的数据）。

## 2. 参数设置模式

在关机状态下，长按“”键 3S，进入参数设置模式：

在设置模式下，“”键和“”键为选择功能，“”为确认功能。

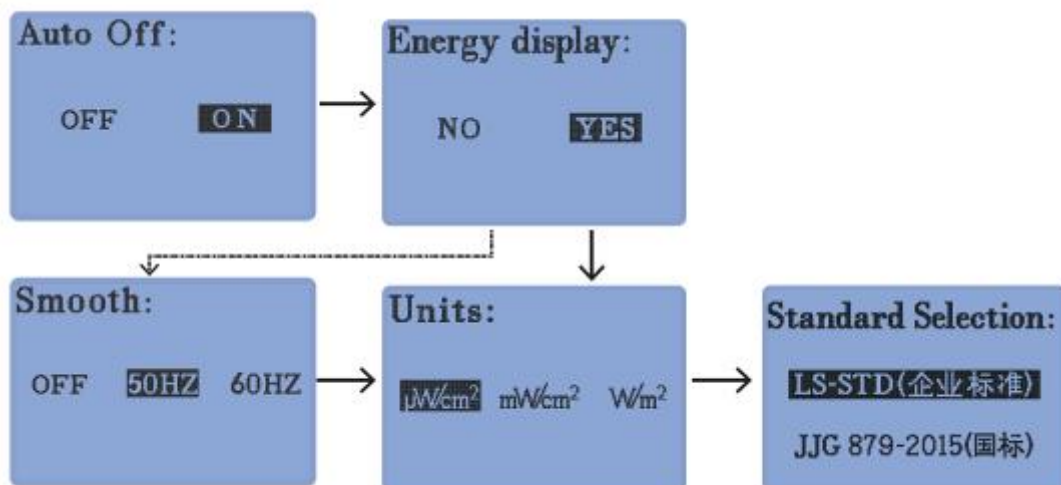

### A. 选择是否自动关机 (Auto Off : ON/OFF)

短按“”键或“”键选择ON/OFF

选择ON，仪器10分钟无操作，自动关机。

选择OFF，仪器需要手动关机，不会自动关机。

短按“”键设置完成，进入下一设置项。

### B. 选择是否显示能量值 (Energy display : NO/YES)

短按“”键或“”键选择NO/YES

短按“”键设置完成，进入下一设置项。

C. 平滑处理 (Smooth : OFF/50HZ/60HZ, 只有高速采集探头有此选项)

如果 UV 光源采用交流供电, 交流电的频率会影响到功率测量, 高速采集探头(2048 次/秒)需要进行平滑处理, 进入平滑处理设置界面, 短按 “” 键或 “” 键选择 OFF/50HZ/60HZ

OFF: 不进行平滑处理, 直流供电, 需选此选项。

50HZ: 50HZ 的交流电, 需选此选项。

60HZ: 60HZ 的交流电, 需选此选项。

短按 “” 键设置完成, 进入下一设置项。

D. 单位选择 (Units :  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  ,  $\text{mW}/\text{cm}^2$  ,  $\text{W}/\text{cm}^2$  ,  $\text{W}/\text{m}^2$ )

短按 “” 键或 “” 键选择所需要的单位(不同探头的单位选项不一样)。

短按 “” 键设置完成, 此时探头型号为 UVALED-X0、UVALED-X1、UVALED-X3 时, 进入下一设置项, 其它探头型号则进入测量模式。

E. 标准选择 (Standard Selection)

短按 “” 键或 “” 键选择标准。


LS-STD (林上标准): 仪器按林上标准调校。

JJG 879-2015 (国标): 仪器按国标调校。

短按 “” 键设置完成, 进入测量模式。

### 3. 测量模式

- 测量模式下, 界面显示功率的实时值、最大值、最小值、平均值, 测量时长, 能量值(根据设置是否显示)。

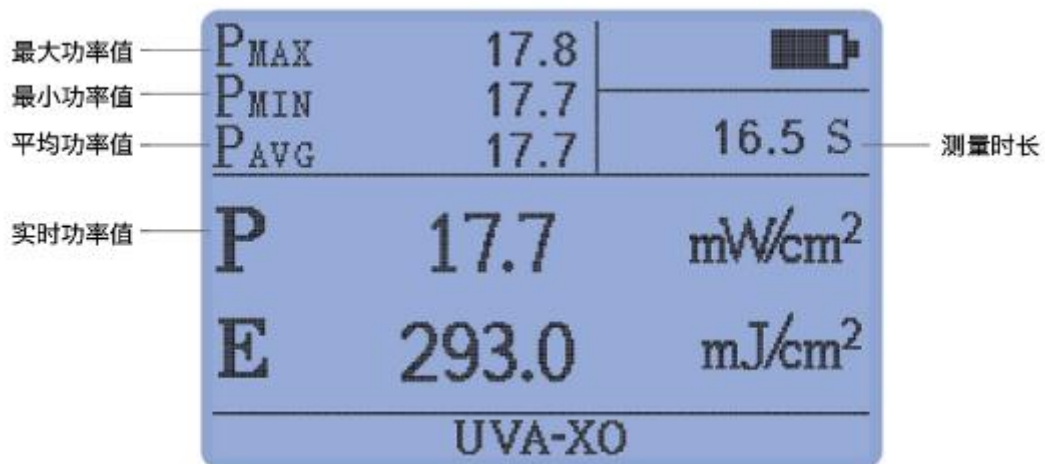


- 测量模式下，如果背光熄灭，短按 “” 键就点亮背光；如果背光已经点亮，短按 “” 键，界面左下角显示 “HOLD” 标志，所有数据在 LCD 上保持，并且将当前数据保存到历史记录中。
- 在 “HOLD” 状态下，如果背光熄灭，短按 “” 键点亮背光；如果背光已经点亮，短按 “” 键，取消 HOLD 功能，开始新的测量。
- 测量模式下，如果背光熄灭，短按 “” 键点亮背光；如果背光已经点亮，短按 “” 键，清除当前数据，重新开始计时，开始新的测量。
- 测量模式下，短按 “” 键或 “” 键，进入历史记录查询模式。

#### 4. 历史记录查询模式

短按 “” 键或 “” 键上翻或者下翻一组记录。最后一组记录为 No.1（仪器最多存储 9 组记录，超过时自动删除最旧的一组记录）。

- 长按 “” 键 3S，清除所有历史记录。
- 短按 “” 键，进入测量模式。

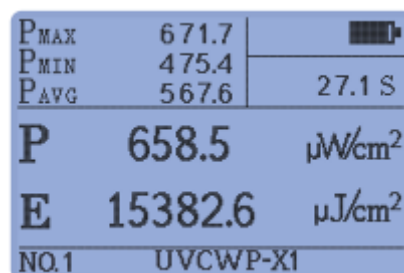

## 5. 航空插头连接

探头的航空插头拔出，航空插头具有弹簧限位，不可暴力旋转拉扯等操作，需如下图方式操作拔出。



## 七、注意事项

1. 不使用时，请长按“”键关机。
2. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
3. 关机后请将其放入专用包装箱内，妥善保管，避免探头感光部分污损。
4. 校验周期：建议校验的周期为一年。
5. 仪器搭配UVCLED-X0、UVB-X0、UVALED-X0、UVALED-X1、UVALED-X3五款探头时，如果需要获取国家计量院的校准证书，需送到华南计量院检测。UVALED-X0、UVALED-X1、UVALED-X3三款探头在送检测前将仪器的“标准选择”选项设置为“JJG 879-2015（国标）”。UVB-X0探头送计量院检测时，需要向注明检测310nm波段。
6. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏，所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时，请务必把探头保存于低湿度环境。
7. 仪器显示 low battery 时，需换新电池。

## 八、标准装箱明细

| 序号 | 品名      | 数量        | 单位 |
|----|---------|-----------|----|
| 1  | 紫外辐照计主机 | 1         | 台  |
| 2  | 测试探头    | 已经订购的探头数量 |    |
| 3  | 说明书     | 1         | 份  |
| 4  | 塑料工程箱   | 1         | 只  |

## 九、售后服务

1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
3. 为用户提供仪器校准服务。
4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司      网址：[www.linshangtech.cn](http://www.linshangtech.cn)

服务热线：0755-86263411      邮箱：[sales@linshangtech.com](mailto:sales@linshangtech.com)